


Référence article: IO9002

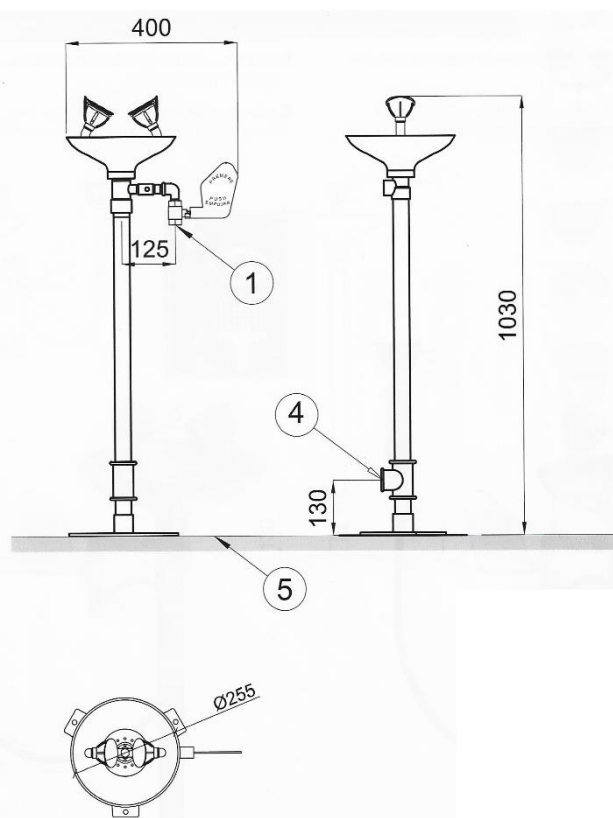

EN CONFORMITÉ AVEC:

norme UNI 9608
norme UNI 10271
norme DIN 12899 PART. 2
norme ANSI Z 358.1-2004
EUROPEAN DIRECTIVE
93/42/CEE dispositif médical
norme prEN15154-1

- ① Ingresso ½" G, filetto femmina
Entrada ½" G, rosca hembra
½" G, inner thread inlet
Entrée ½" G, filetage femelle
- ④ Uscita 1 ¼" G, filetto femmina
Salida 1 ¼" G, rosca hembra
1 ¼" G, inner thread outlet
Sortie 1 ¼" G, filetage femelle
- ⑤ Pavimento finito
Suelo acabado
Finished floor
Sol fini

Description	Lave-yeux de sécurité sur colonne avec vasque
Matériau vasque	polypropylène
Raccords	laiton
Brise-jet	aérée
Débit max total	14 l/min ±10% (0,3 MPa)
Entrée	1/2" F
Échappement	1,1/4" F
Activation	par poussée latérale
Température d'eau recommandée	min 15° - max 35°C
Pression d'alimentation dynamique	min 0,2MPa max 0,5MPa
Débit min requis	6 l/min at 0,2 MPa
Couleur	vert - RAL 6029

Rubinetterie F.Ili CREVOLA snc di Crevola F. & C.
C.F. / P.IVA: 00898050034

Codice Meccanografico Esportatore: NO015963

VIA LOVAGO, 2 – 28076 POGNO (NO) ITALIA. Tel. + 39 0322 97 303 Fax + 39 0322 996 812

www.fratellicrevola.com e-mail: info@fratellicrevola.com